

UBND TỈNH TRÀ VINH

SỞ Y TẾ

Số: 38/BC-SYT

BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁC

(Theo Thông tư số: 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Thời gian từ ngày 23/12/2021 đến ngày 03/01/2022

Kính gửi:

- Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu							Thông tin chung		Kết quả thực hiện												
STT	Tên trang thiết bị y tế	Phân nhóm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Nguồn vốn đầu tư	Số lượng định mức	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại (model) / Mã sản phẩm	Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu	Năm sản xuất	Nước sản xuất	Hãng sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Đơn giá trúng thầu (VND)	Tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị trúng thầu	Mã số thuế của đơn vị trúng thầu	Ghi chú
Quyết định phê duyệt dự toán Số 2932/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh							Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Số 1227/QĐ-SYT ngày 23 tháng 12 năm 2021		Tên gói thầu: Gói thầu số 14: Quà lọc máu hấp phụ (gồm 01 mặt hàng) phục vụ phòng, chống dịch Covid-19												
Tên gói thầu: Gói thầu số 14: Quà lọc máu hấp phụ (gồm 01 mặt hàng)																					
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi định thầu rút gọn																					
1	Quà lọc hấp phụ HA330	6	20	Bộ	12.075.000	241.500.000	Quỹ dự trữ tài chính		Quà lọc hấp phụ HA330	HA330		2021	Trung Quốc	Jafron	Jafron/Trung Quốc	Bộ	12.075.000	Quà lọc máu hấp phụ Cytokin HA330. Vật liệu vỏ Polycarbonate (PC). Vật liệu hấp phụ là các hạt Resin bản chất là Styrene divinylbenzene copolymers được xử lý bằng công nghệ "Crosslinking kép" (hạt màu nâu) nên có tính tương đồng sinh học cao. Vật liệu màng bọc hạt hấp phụ: Collodion. Thể tích hấp phụ (mL): 330±3. Thể tích khoang máu(mL): 185±5. Diện tích hấp phụ: 104.000m ² . Nội trở lên đến 4kPa. Lưu lượng máu tối đa: 250ml/phút. Áp suất chịu đựng lên đến: 100kPa. Độ chịu lực của hạt: 8,1N. Dải hấp phụ: 10~60kDa. Phương thức khử trùng: Tia Gamma. Tỷ lệ hấp phụ tính sau 2h trên invivo: Endotoxin: 36.7% ~ 52.5%; TNF: 31.1% ~ 71.2%; IL-1β: 35%. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EC	Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Giải Pháp Việt	0106255872	

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO


(ký tên, ghi rõ chức danh, đơn vị công tác)



Ưng Quốc Điền

Dược sỹ
Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

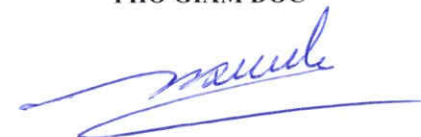

Trần Đắc Thanh